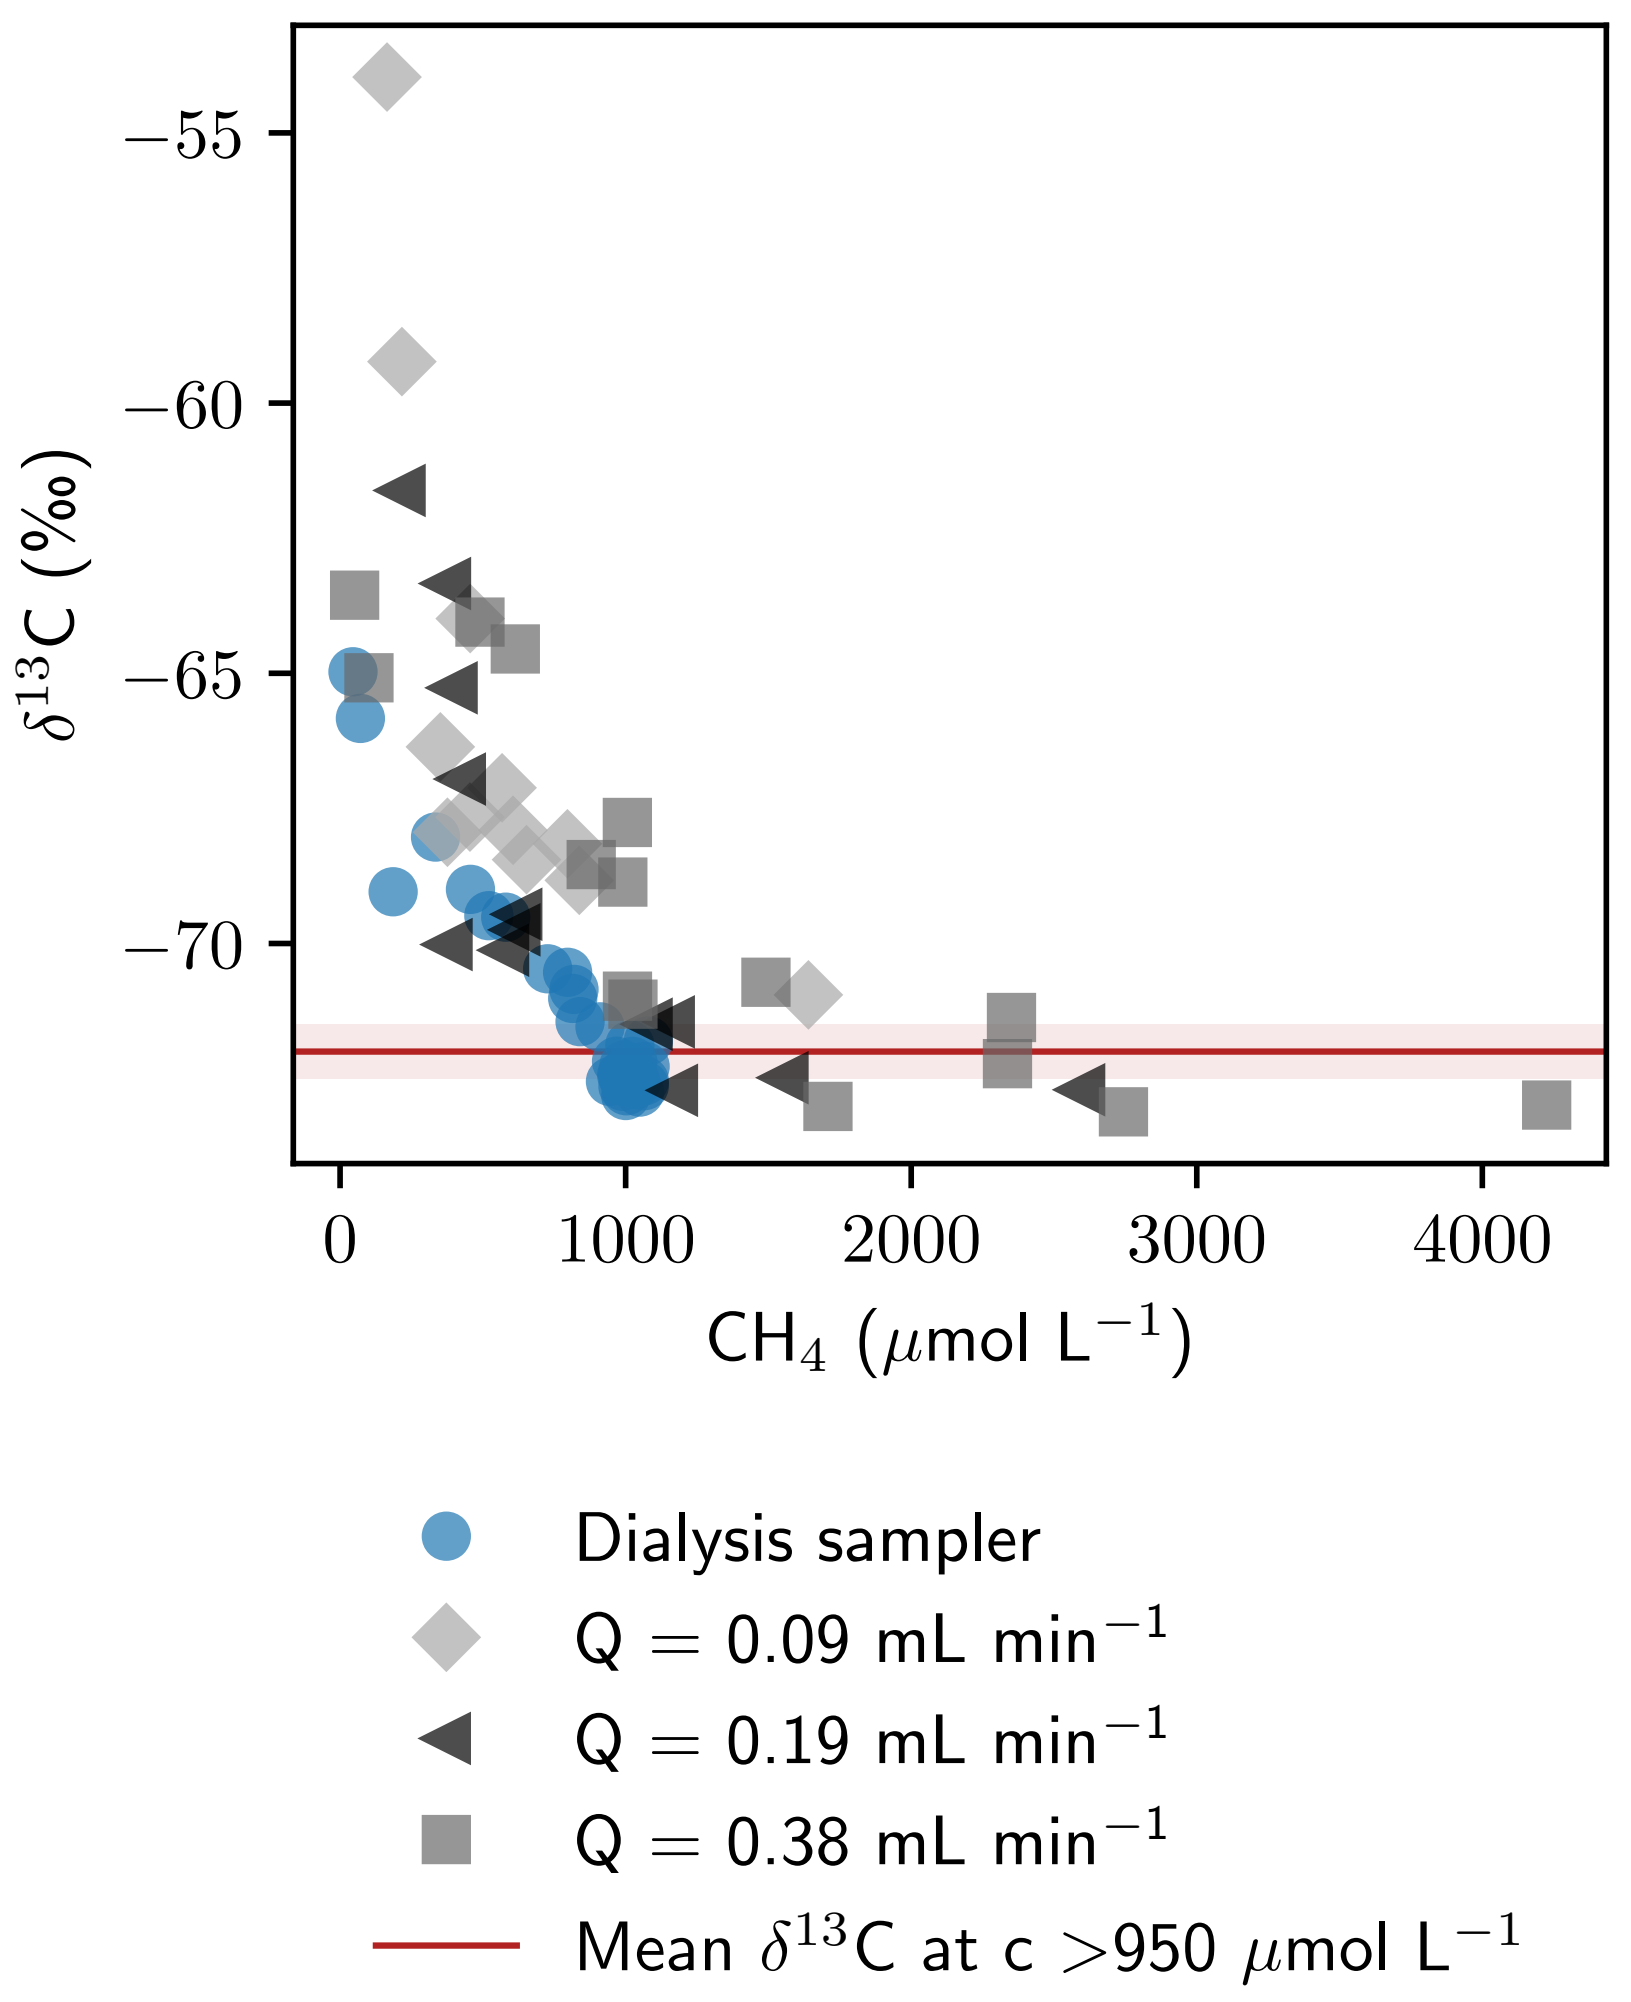
−55
−60
−65
−70
δ^{13}C (‰)
0
1000
2000
3000
4000
CH_4 (μmol L^{-1})
Dialysis sampler
Q = 0.09 mL min^{-1}
Q = 0.19 mL min^{-1}
Q = 0.38 mL min^{-1}
Mean δ^{13}C at c >950 μmol L^{-1}